

**CARTA CONTROLE – *Echinometra lucunter*
(18 de janeiro de 2018)**

Av. Carlos Chagas Filho, 791
Pólo Bio-Rio // Laboratório 4
Cidade Universitária // Ilha do Fundão
CEP 21941-904 // Rio de Janeiro // RJ
55 (21) 3867 5651 // 55 (21) 3525 2466
Email: labtox@labtox.com.br
http://www.labtox.com.br


Resultados obtidos com a substância padrão dodecil sulfato de sódio (DSS), nos ensaios conduzidos entre o período de 12 de julho de 2016 a 19 de abril de 2017 com *Echinometra lucunter*.

Os resultados apresentam um valor médio do percentual de inibição (CI₅₀ (I)) de 2,11 mgDSS.L⁻¹ (n = 20), desvio padrão de 0,50 e coeficiente de variação de 23,85%.

O intervalo estabelecido para esta espécie nos ensaios realizados pelo Labtox é de 1,10 a 3,11 mg.L⁻¹ (média ± 2 desvio padrão).

Representação do resultado obtido no ensaio de 15/01/2018

CI₅₀ (I): 2,01 mg.L⁻¹ (IC: 1,96 – 2,05 mg.L⁻¹)

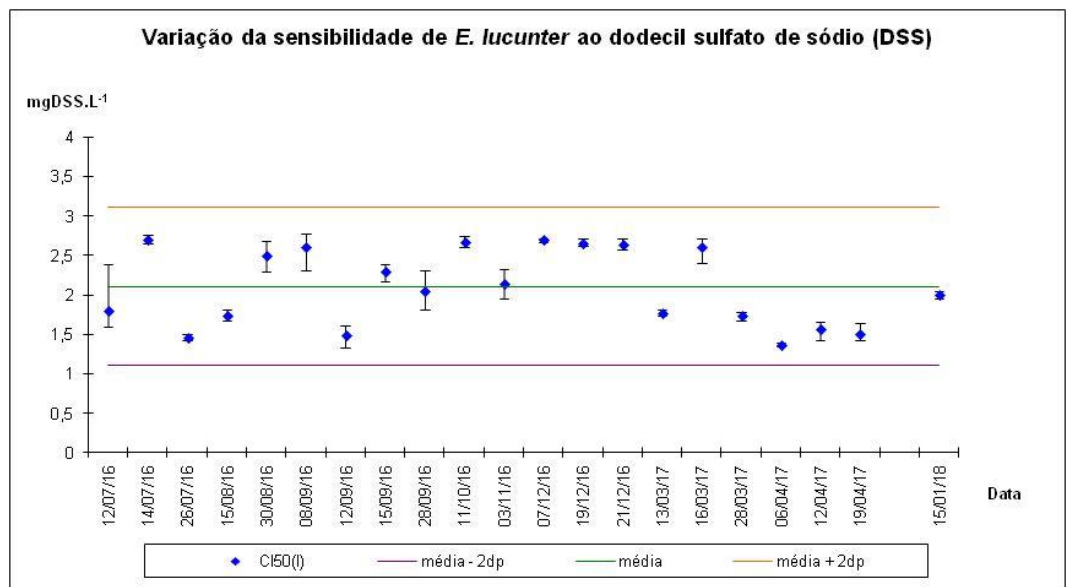

ELABORADO POR:

Viviane Euzebio Luiz
CrBio-2 – 42535/02

Viviane Euzebio Luiz

REVISADO POR:

MSc Leila A. Silva Kraus
CRBio-2 - 12156/02

Leila Aparecida da Silva Kraus